


外形図


OX100 雰囲気ガス管理用酸素濃度計

単位:mm

本体

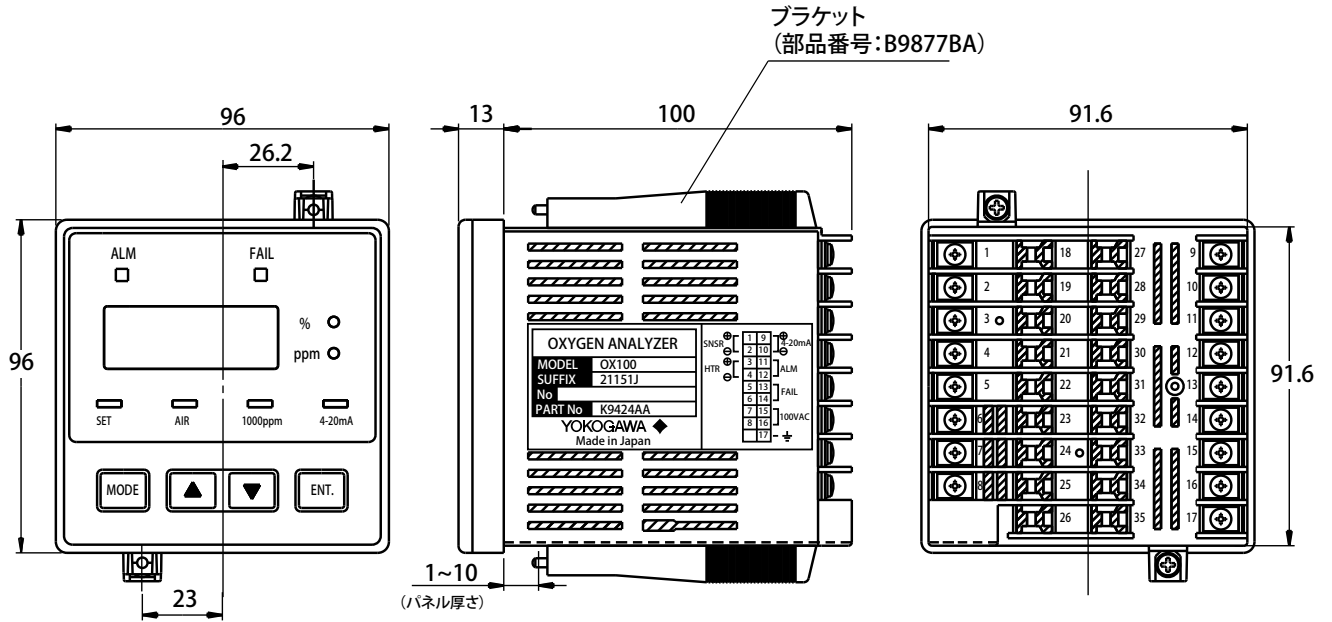

パネルカット寸法図

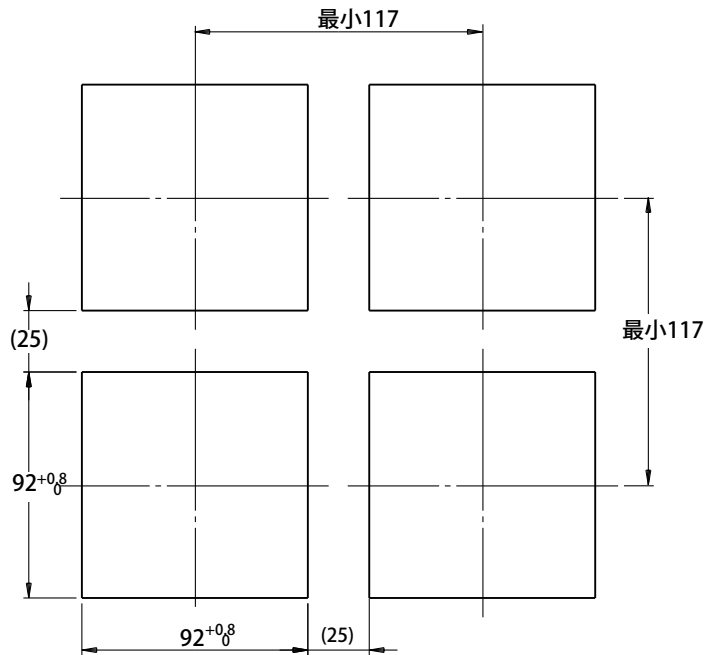

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=±(JIS B0401-1998の公差等級IT18の差)/2」とします。

